Die Anwendung der FLEXOPLUS GENO Ohrmarke zur Gewebeprobenahme

I Trennen Sie die vier miteinander verbundenen Ohrmarkenteile in der Mitte ❶. **Vermeiden Sie dabei jede Berührung des Schneidringes an der Spitze des Dornteiles**. Legen Sie die visuelle Ohrmarke an einer sauberen Stelle ab.

Zuerst die Gewebeohrmarke setzen!

II Die **Gewebe-Ohrmarke** in die Caisley Ohrmarkenzange laden. Dazu die folgende Reihenfolge unbedingt beachten:

a) die Metallklammer an der Lochteilseite (schwarzer Clip) der Zange **nach innen drücken und vollständig nach hinten schwenken!** Die Klammer kippt dabei zum Drehpunkt der Zange ab ❷.

b) Das Lochteil mit dem Gewebeprobenröhrchen von innen in die Zangenbacke einsetzen und ganz eindrücken ❸.

c) Die Klammer loslassen. **Sie hält die Lochteillasche jetzt fest** ❹.

d) Das Dornteil vom Lochteil trennen ❺.

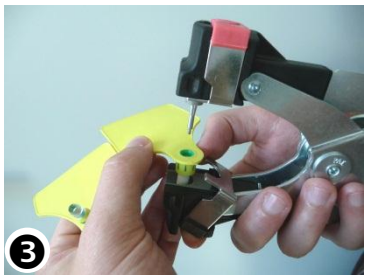

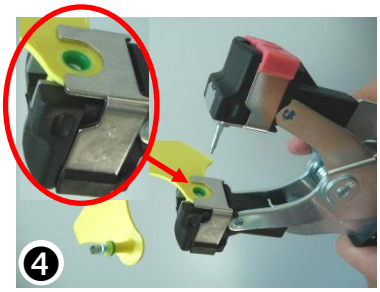

III Stecken Sie das Dornteil auf den metallenen Führungsdorn in der Zange und überwinden Sie die Rastung am Ende ❻. **Berühren Sie beim Aufstecken nicht den Schneidring und den Dorn, sondern fassen Sie das Dornteil an der Lasche an, um Verschmutzungen der Probe und Infektionen der Ohrwunde zu vermeiden und die Probe nicht zu verunreinigen.**
Die Zange ist jetzt zur Entnahme der Gewebeprobe und Anbringung der Ohrmarke vorbereitet.

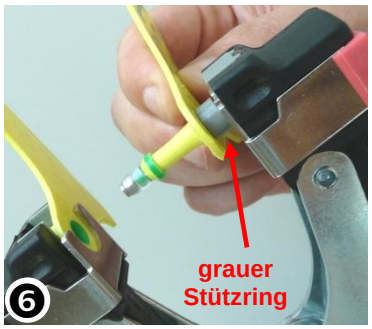

*Im Lieferzustand ist die Zange mit einem **grauen Stützring** auf dem metallenen Führungsdorn versehen, der das Dornteil der Ohrmarke beim Einziehen abstützt. Sollte der Stützring sich beim Gebrauch der Zange lösen, clipsen Sie ihn erneut auf den Führungsdorn*

IV Bringen Sie die **Gewebe-Ohrmarke**

a) zwischen den beiden Knorpelleisten
b) ohne Blutgefäße zu verletzen
c) ca. 1/3 bis 1/2 Ohrlänge von Ohrgrund entfernt
d) mit dem Dornteil am Außenohr und
e) dem Lochteil am Innenohr an ❼.

ACHTUNG
Die Zange mit der Ohrmarke nur einmal - aber zügig und kräftig – bis zum Anschlag schließen!

Richtige Position

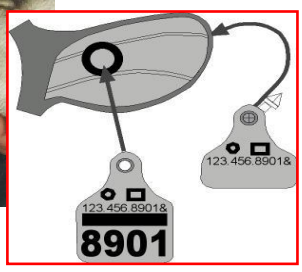

V Anschließend die Zange **unmittelbar nach dem einmaligen kräftigen Schließen bis zum Anschlag wieder aufspringen lassen**. Ziehen Sie die Zange im Bogen nach unten vom Ohr des Tieres ab, so dass das Lochteil nach vorn aus der unteren Zangenbacke gleitet.

BITTE WENDEN

WICHTIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORM
TIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORMATION

Caisley International GmbH

Der Schneidring stanzt ein Loch in das Ohr. Das anfallende Gewebe wird in das Probenröhrchen überführt, welches durch das Projektil hermetisch verschlossen wird. Das Probenröhrchen verbleibt in der Zangenbacke.

VI Um das **Probenröhrchen** aus der Zange zu **entnehmen**, drücken Sie das Röhrchen mitsamt dem schwarzen Clip und dem metallenen Bügel nach oben, so dass das Probenröhrchen aus der Zangenbacke in Richtung der Zangenöffnung bewegt wird ❽. Dann die Metallklammer loslassen. Das aus der Zangenbacke vorstehende Probenröhrchen kann nun leicht aus der Zange entnommen werden ❾.

Übermitteln Sie das Probenröhrchen umgehend auf dem vorgegebenen Weg an das für die Untersuchung zuständige Labor.

❽

❾

Das Probenröhrchen nicht im Bereich von Einstreu oder Spaltenboden aus der Zange entnehmen – Verlustgefahr!

Film zur Anwendung www.caisley.de im Internet

Die Anwendung der visuellen *Flexo*Plus-Ohrmarke zur Tierkennzeichnung

Dann die visuelle Ohrmarke setzen!

VII Die ***Flexo*Plus-Ohrmarke** in die UniversalOhrmarken-Zange laden. Dazu:

a) die Metallklammer an der Lochteilseite (schwarzer Clip) der Zange nach innen drücken ①.
b) Das *Flexo*Plus-Lochteil mit dem Kragen nach außen unter die Metallklammer (schwarzer Clip) einsetzen ②. Dabei die Spitze des Dornteiles nicht berühren.
c) Das Dornteil vom Lochteil abtrennen ③ und
d) auf den metallenen Führungsdorn bis über die Rastung am Ende drücken ④. **Berühren Sie auch hier nicht den Dorn, sondern fassen Sie das Dornteil an der Lasche an, um Infektionen der Ohrwunde zu vermeiden.**

Die Zange ist jetzt zur Anbringung der visuellen Kennzeichnung vorbereitet.

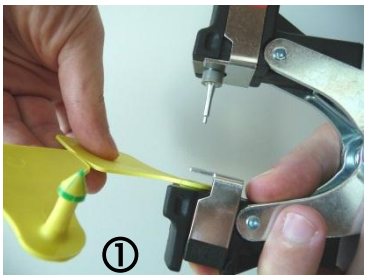
①

②

③

④

VIII Bringen Sie die ***Flexo*Plus-Ohrmarke**

a) zwischen den beiden Knorpelleisten
b) ohne Blutgefäße zu verletzen.
c) ca. 1/3 bis 1/2 Ohrlänge von Ohrgrund entfernt
d) mit dem **Dornteil am Außenohr** und
e) dem **Lochteil am Innenohr**

durch **einmaliges kräftiges Schließen** der Zange (Knackgeräusch) **bis zum Anschlag** an!
Die *Flexo*Plus-Ohrmarke ist jetzt verschlossen

Richtige Position

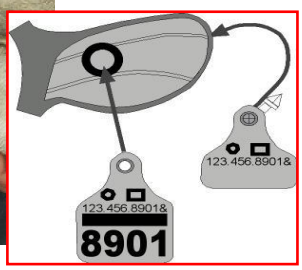

IX Lassen Sie die Zange **unmittelbar nach einmaligen kräftigen Schließen bis zum Anschlag wieder aufspringen** und ziehen Sie die Zange im Bogen vom Ohr des Tieres ab, so dass das Lochteil aus der unteren Zangenbacke gleitet.

Prüfen Sie nach einigen Tagen die Wundheilung und desinfizieren Sie die Wunde, falls nötig.

WICHTIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORM
TIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORMATION - BITTE UNBEDINGT LESEN - WICHTIGE INFORMATION